



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางทันตกรรม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุทางทันตกรรม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซื้อวัสดุทางทันตกรรม จำนวน ๗ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๘๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประจักษ์ ทองบัว)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน
1	Amalgam Plugger (วัสดุอุดตัวอุดฟัน)	40 ชิ้น	110.00	4,400.00
2	Amalgam Burnisher (วัสดุรีดตัวอุดฟัน)	40 ชิ้น	110.00	4,400.00
3	Amalgam Carver (วัสดุแต่งขอบตัวอุดฟัน)	40 ชิ้น	110.00	4,400.00
4	Cleoid Discoid (วัสดุแต่งด้านบดเคี้ยว)	20 ชิ้น	110.00	2,200.00
5	Tofflemire matrix retainer (เครื่องมือยึดแผ่นโอบฟันแบบเต็มซี่)	10 อัน	750.00	7,500.00
6	Ivory matrix retainer (เครื่องมือยึดแผ่นโอบฟันแบบครึ่งซี่)	10 อัน	750.00	7,500.00
7	Explorer (เครื่องมือตรวจหารอยผุ)	40 อัน	110.00	4,400.00
			รวมเป็นเงิน	34,800.00


Amalgam Plugger

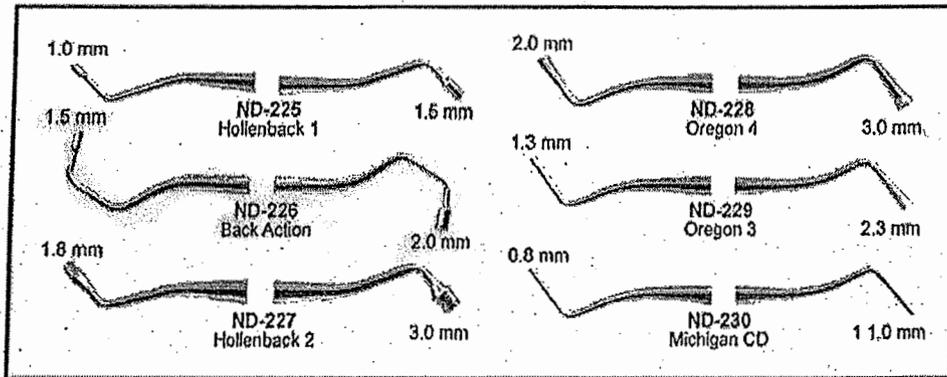

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสแตนเลสที่ไม่เป็นสนิม
2. ใช้สำหรับกดแต่งวัสดุอุดฟัน
3. สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยใช้ออกซิเจนไดออกไซด์ได้


Burnisher

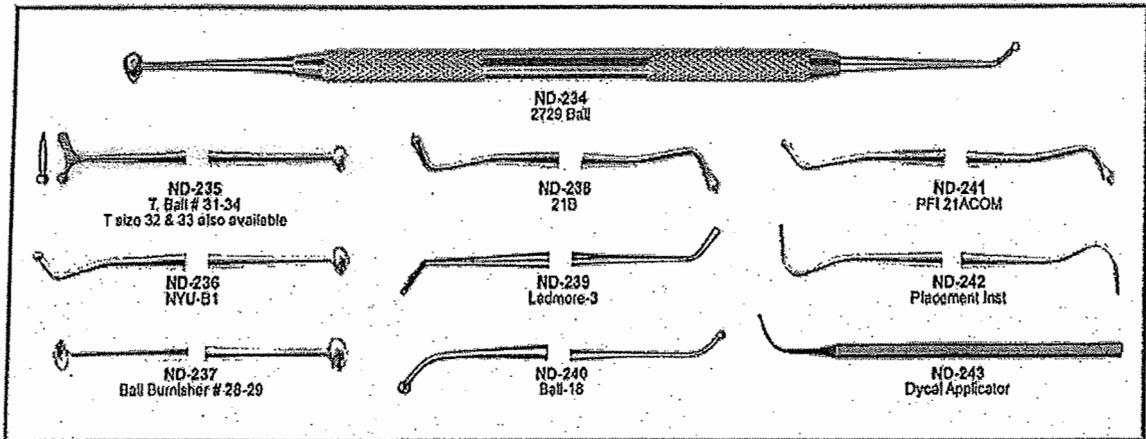

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผลิตภัณฑ์สแตนเลสไม่เป็นสนิม
2. เป็นสแตนเลสทั้งชิ้น ไม่มีรอยต่อ
3. เป็นเครื่องมือใช้ในงานอุดฟัน
4. สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยใช้ออโตคลฟได้


Amalgam Carver Hollenback

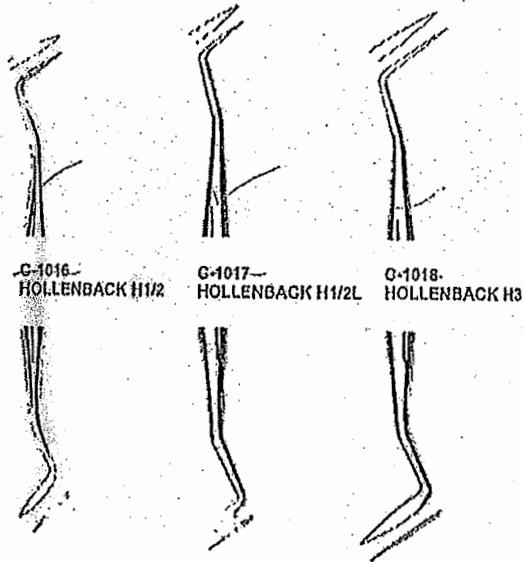

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสแตนเลสที่ไม่เป็นสนิม
2. ใช้สำหรับแต่งวัสดุอุดฟัน
3. สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยใช้ออโตเคลฟได้


Discoid Cleoil

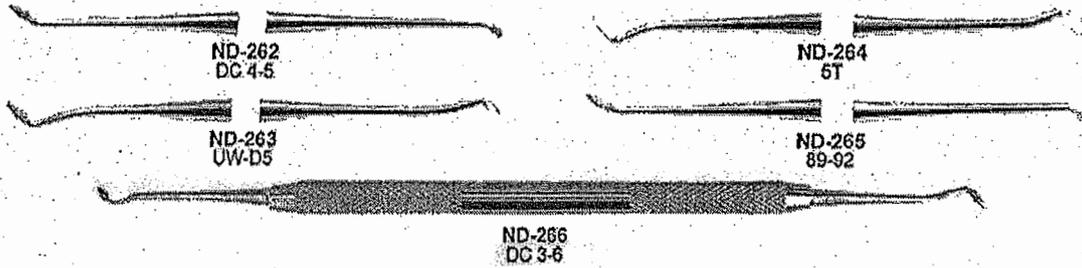

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสแตนเลสไม่เป็นสนิม ขนาด 1.5 mm
2. เป็นสแตนเลสทั้งชิ้นไม่มีรอยต่อ
3. สามารถเข้า Autoclave ได้


Matrix retainer Tofflemire

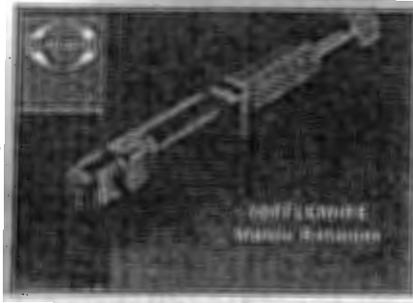

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสแตนเลส ไม่เป็นสนิม
2. ใช้สำหรับจับแผ่น Matrix band ในการโอบซี่ฟัน สำหรับการอุดฟัน
3. ลักษณะตัวรัด โดยใช้ Matrix band สอดเข้าไปแล้วหมุนด้านท้ายให้ตั้ง
4. สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยการนำเข้าไป Autoclave


Matrix retainer Ivory

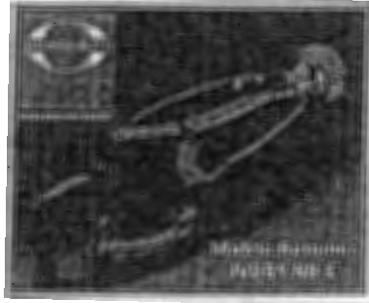

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสแตนเลส ไม่เป็นสนิม
2. ใช้สำหรับจับแผ่น Ivory ในการโอบซีฟัน สำหรับการอุดฟัน
3. ลักษณะตัวรัดเป็นรูปกำมปู มีตัวหมุนอยู่ด้านท้าย
4. สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยการนำเข้า Autoclave

เครื่องมือตรวจหารอยของฟัน (Explorer)



คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องมือใช้สำหรับการตรวจฟัน

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ใช้สำหรับการตรวจฟัน
2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสแตนเลสไม่เป็นสนิม
3. เป็นสแตนเลสหล่อทั้งชิ้นไม่มีรอยต่อ
4. ปลายเครื่องมือด้านหนึ่ง มีลักษณะโค้ง ปลายเรียว ปลายอีกด้าน มีลักษณะคล้ายตะขอ
5. สามารถเข้า Autoclave ได้